


CTデータを拡大して観察する


v1.36 版

CTデータを拡大したり、回転する中心を変更することができます。


CTデータを表示したら、下部の  をクリックします。

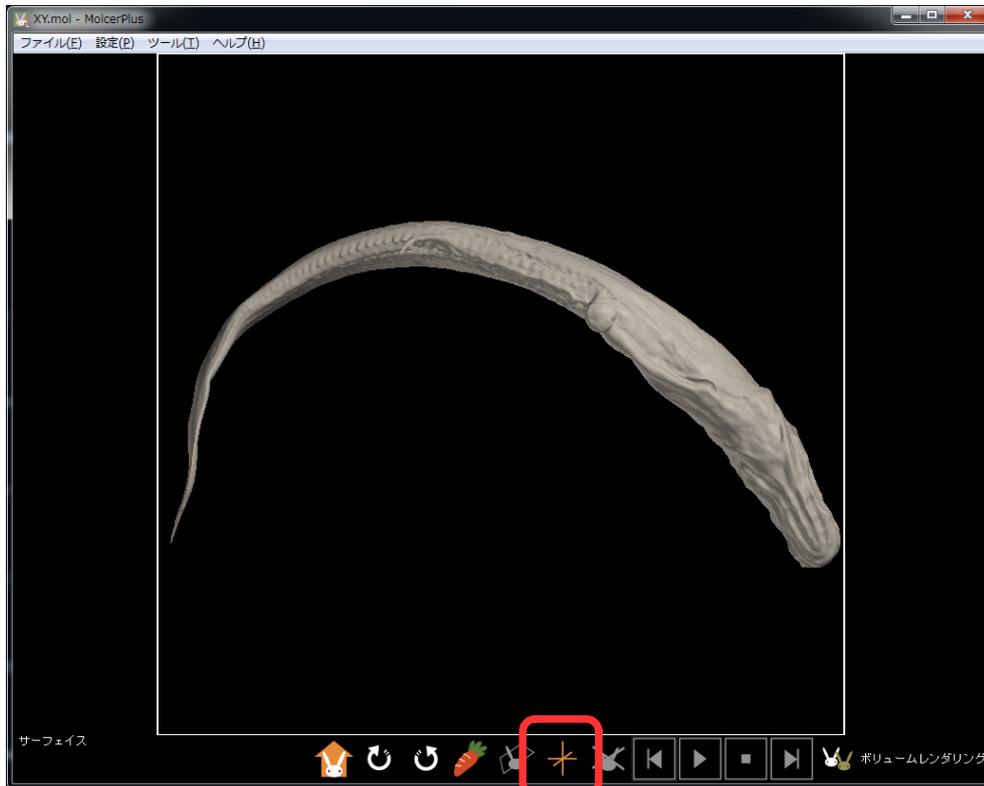


回転の中心としたい部分 (矢印) をクリックします。

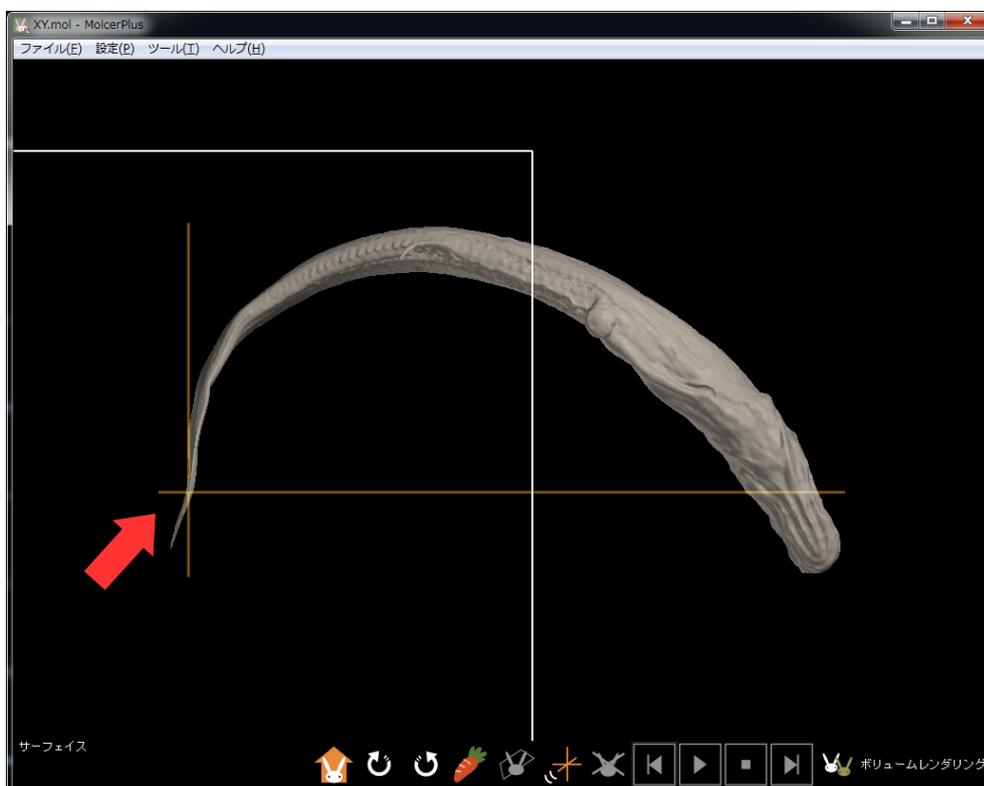

右クリックを押したままマウスを動かして、回転の中心とする部分を画面中央に移動させます。

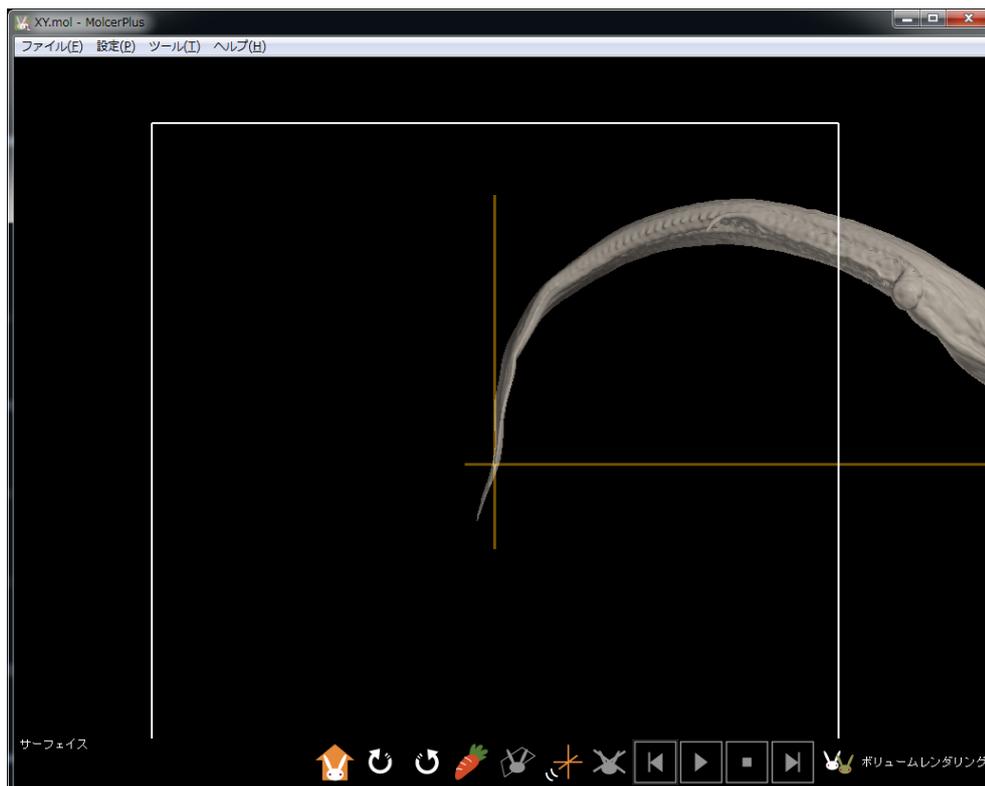

マウスホイールを回して拡大します。

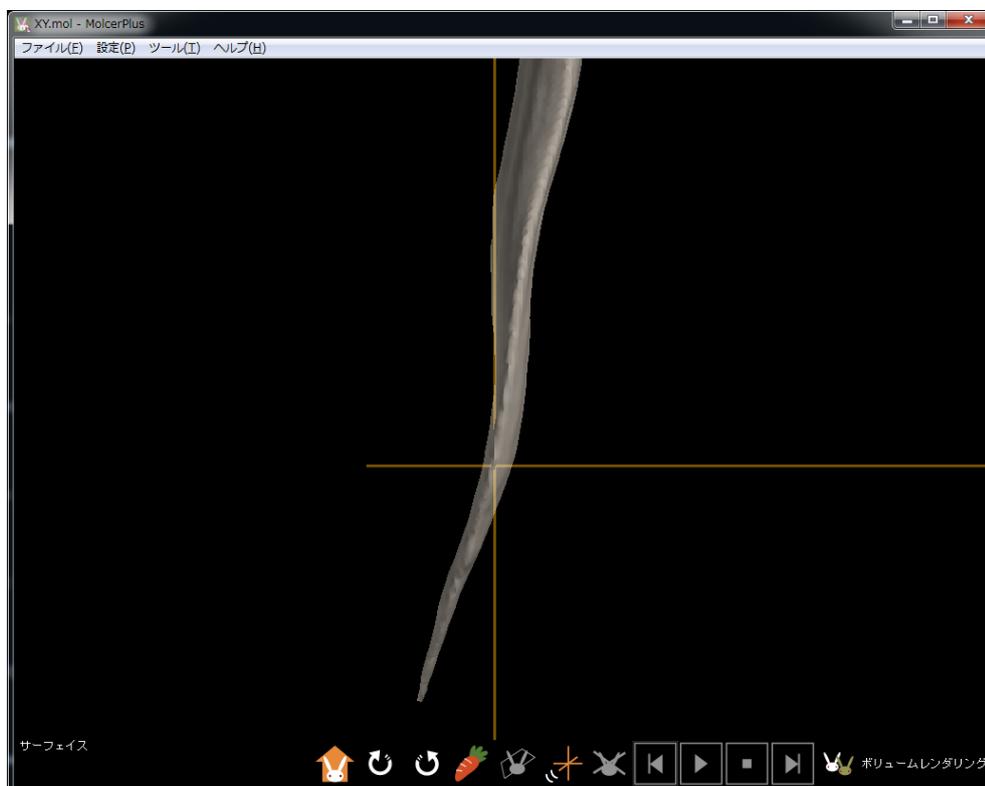

尻尾を回転の中心として、動かせるようになりました。

